


PELVI.Loc TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL

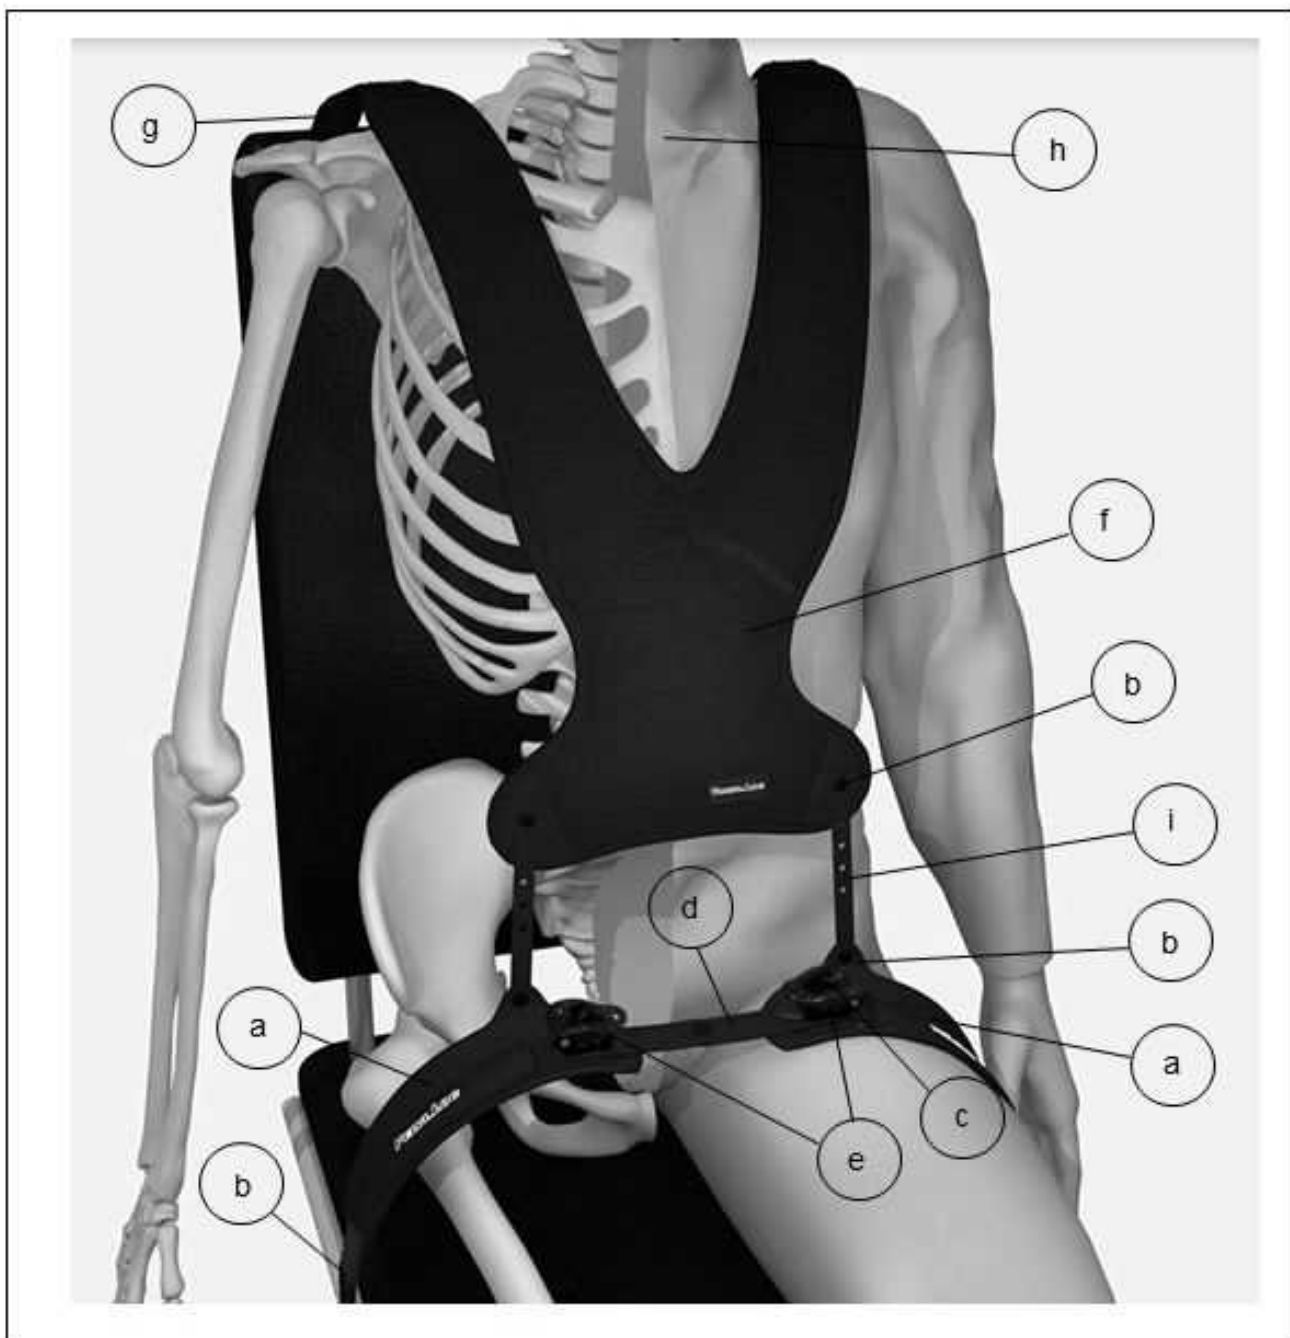

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.

Zakres stosowania

Torso.Loc TL-3DSR służy do pozycjonowania i stabilizowania miednicy na siedzeniu u osób o ograniczonej sprawności ruchowej np. siedzących na wózku prysznicowym, krześle kąpielowym, wózku inwalidzkim, krześle terapeutycznym, wózku rehabilitacyjnym.

Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x TL-3DSR bez wstępnego montażu
- 2) 1 x TL- bez wstępnego montażu
- 3) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online/wskazówki

Łączenie wyrobów medycznych

Nadaje się do urządzeń przeznaczonych do użycia z pasem do stabilizacji miednicy w połączeniu z kamizelką pozycjonującą górną część ciała.



Cel zastosowania

Torso.Loc TL-3DSR w połączeniu z Torso.Loc TL-W jest przeznaczony dla osób o ograniczonej mobilności, szczególnie w zakresie pozycjonowania miednicy, uda i górnych partii ciała, zapobiegając przesuwaniu się miednicy do przodu i przechylaniu się górnej części ciała do przodu.



Montaż

- Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:
1. Umieścić podkładki (a) pod każdym udem. – Opaska zębata (b) jest przymocowana do wózka inwalidzkiego.
 - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce!
 2. Ustawić odstęp między podkładkami nad pasami perforowanymi (d).
Po uruchomieniu klamer zapadkowych (e) napina się pas stabilizujący miednicę.
 - Złącze pasa perforowanego należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
 - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą kłamrą zapadkową (e) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.
 1. Następnie przymocować opaskę zębatą (b) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
(Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu)
 2. Naciągać opaskę zębatą (b) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
 3. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
 4. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!
 5. Założyć kamizelkę (f) na górną część ciała. – Taśma paska (g) jest przymocowana po obu stronach wózka (przykręcona lub za pomocą klamry zaciskowej 25 mm).
 - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce!
 6. Ustawić odległość kamizelki neoprenowej od szyi (h) za pomocą taśmy paska (g) tak, aby nie było niebezpieczeństwa uduszenia się.
 7. Skrócić dwie taśmy perforowane (i) TL-3DSR i TL-W. W razie potrzeby odciąć zbyt długą taśmę perforowaną.
Regulacja pasków perforowanych (i) powoduje naciągnięcie kamizelki neoprenowej.
 - Kamizelka neoprenowa powinna zostać wyśrodkowana tak, aby pasowała do konturu ciała.
 8. Lekko dociągnąć i umieścić kamizelkę neoprenową za pomocą taśmy paska (g).
 9. Naciągać pasy na łopatki (g) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy szyją a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko (niebezpieczeństwo zaczerwienienia skóry).
 10. W razie potrzeby można przyciąć końce taśmy paska (g).



Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie Torso.Loc co 6 miesięcy. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony. - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak taśma paska/paski perforowane (i), opaska zębata (b) lub podkładka (a) kamizelka (f) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach! - niebezpieczeństwo powstania odcisków głównie z powodu zapadek (e)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej Torso.Loc. Ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między paskiem perforowanym a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem. Niebezpieczeństwo zgniecenia!

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie używać Torso.Loc, jeśli w obrębie poduszek znajdują się miejsca odcisnięte.
- Gdy są rany lub niewyleczone miejsca. –Niebezpieczeństwo zranienia!
- Nie należy używać Torso.Loc w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia. –Niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie Torso.Loc!
- Uszkodzony Torso.Loc należy natychmiast wymienić. - ryzyko wypadku!



Uwaga:

Toros.Loc nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.

- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent, ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

Zastosowanie

1. Aby użyć Torso.Loc podkładki (a) należy umieścić na udach.



Uwaga:

1. Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków!
2. Następnie przepuść opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
4. Upewnić się, czy zapadki (c) współpracują z zębami opaski zębatej!
 - Przeprowadzić próbę rozciągania!

Aby otworzyć Torso.Loc należy uruchomić zapadkę (c) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

Konserwacja

Torso.Loc należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzony Torso.Loc należy natychmiast wymieniać.

Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.

Dane techniczne TL-3DSR

Szerokość siedziska:	XS	16 do 24 cm
Wielkość podkładki:	XS	18x7, cm
Waga:	XS	ok. 220 g
Rozerwanie:	XS	przy ok. 60 kg

Szerokość siedziska:	S	20 do 32 cm
Wielkość podkładki:	S	21 x 8 cm
Waga:	S	ok. 220 g
Rozerwanie:	S	przy ok. 60 kg


Szerokość siedziska:	M	30 do 40 cm
Wielkość podkładki:	M	25,5 x 8 cm
Waga:	M	ok. 280 g
Rozerwanie:	M	przy ok. 80 kg

Szerokość siedziska:	L	36 do 46 cm
Wielkość podkładki:	L	26,5x8,5 cm
Waga:	L	ok. 280 g
Rozerwanie:	L	przy ok. 80 kg

Rozmiar opaski zębatej: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Rozmiar opaski zębatej: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

Dane techniczne TL-W

Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W- M	38	29	16	19	5	13
TL-W- L	47	37	19	22	6	14
TL-W- XL	55	45	24	26	6,5	17

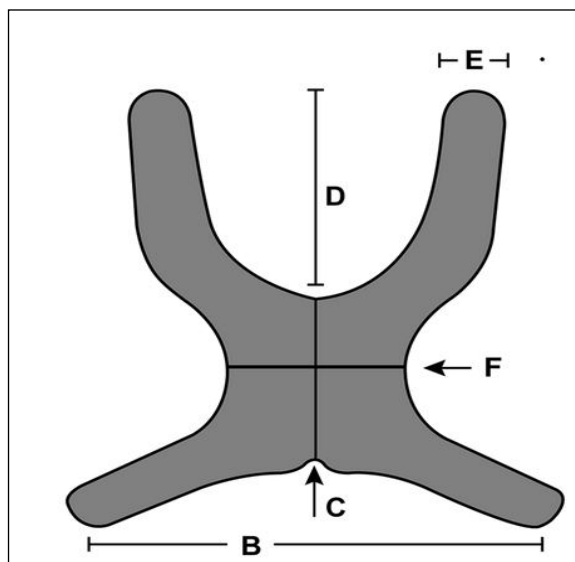

Produkt nie zawiera lateksu



Gwarancja

Na produkt udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają części i podzespoły zużywające się, które podlegają normalnemu zużyciu, jak również uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji, "użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem", uszkodzeń mechanicznych lub niedozwolonych modyfikacji/napraw. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt, prace naprawcze, konserwacyjne i nadzór mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J Ltd
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tel: +49 (08373) 987269
Faks: +49 (08373) 987276
e-mail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.

Stan 01122018
Zastrzega się możliwość zmian technicznych